

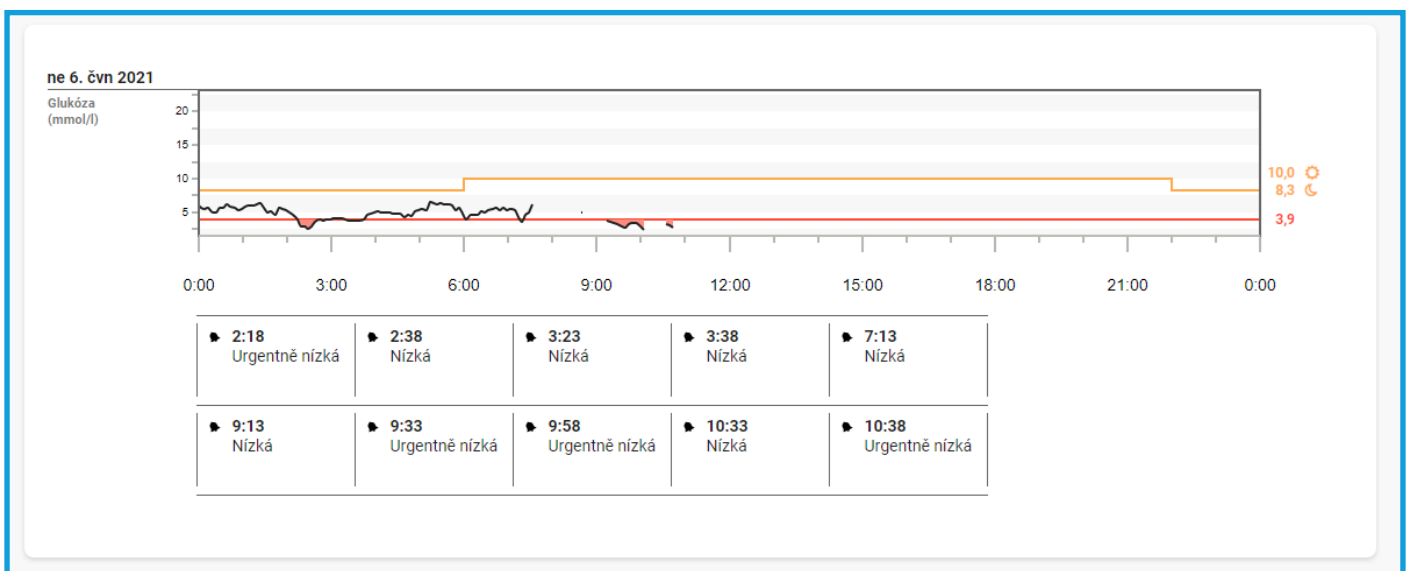
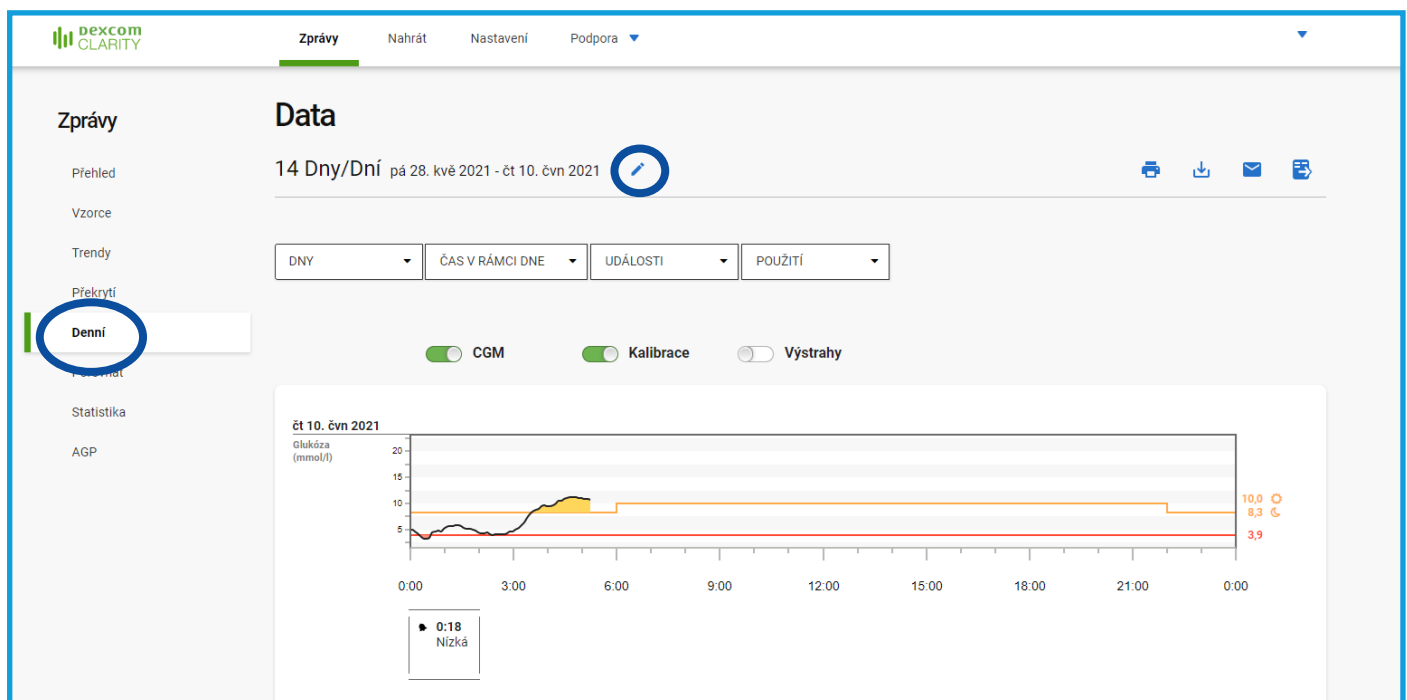


## Vzory grafů - nutné k reklamaci

### Graf z CLARITY:

Nutné je vybrat časové rozmezí ode dne nastřelení senzoru, až po jeho selhání.

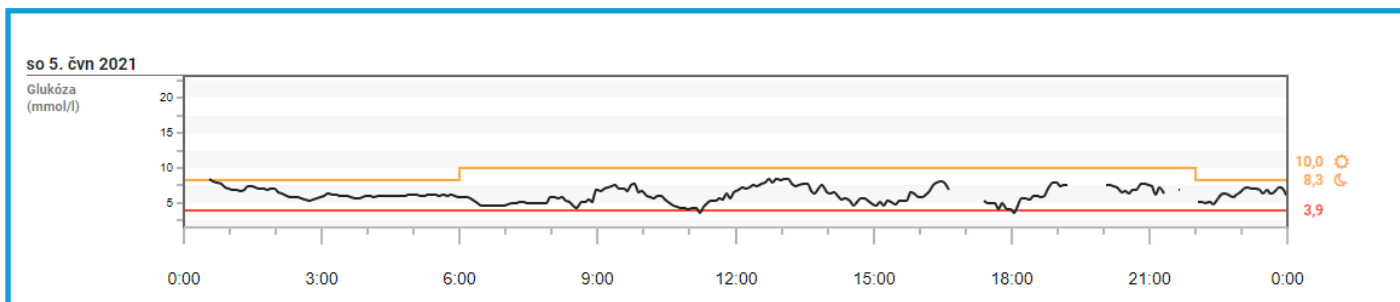

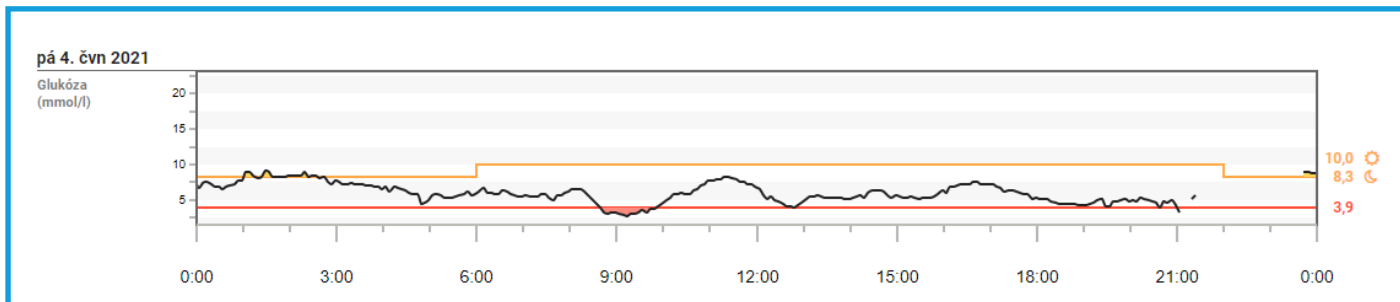

## Graf z DIASENDU:

Uživatelé, kteří mají pouze inzulinovou pumpu a nepoužívají mobilní aplikace, přikládají grafy z DIASENDU.

Vzory chybových hlášek z displeje telefonů nebo inzulinové pumpy:

